

ProChemist/AS

メール発信設定の変更

Ver 2.11

メール発信設定の変更が必要なお取引先様

JAMP-AIS調査フォーマットを選択された方の内、

1. 新しくサプライヤWeb企業IDを入手された方
2. 既存サプライヤWEB企業IDにユーザーIDを追加された方

お問い合わせ先

NEC ProChemist/AS ヘルプデスク

ProChemistにログイン後、[Help]をクリックして、Helpページに記載されているメールアドレスにご連絡ください。

・問合せメールには電話番号をご記入ください。(電話での確認を行う場合があります)



カシオ計算機株式会社


casio_green_procurement@casio.co.jp (日本語/英語専用)

または、資材担当者

2016年 7月

カシオ計算機株式会社
生産資材統轄部

ProChemist/AS メール発信設定

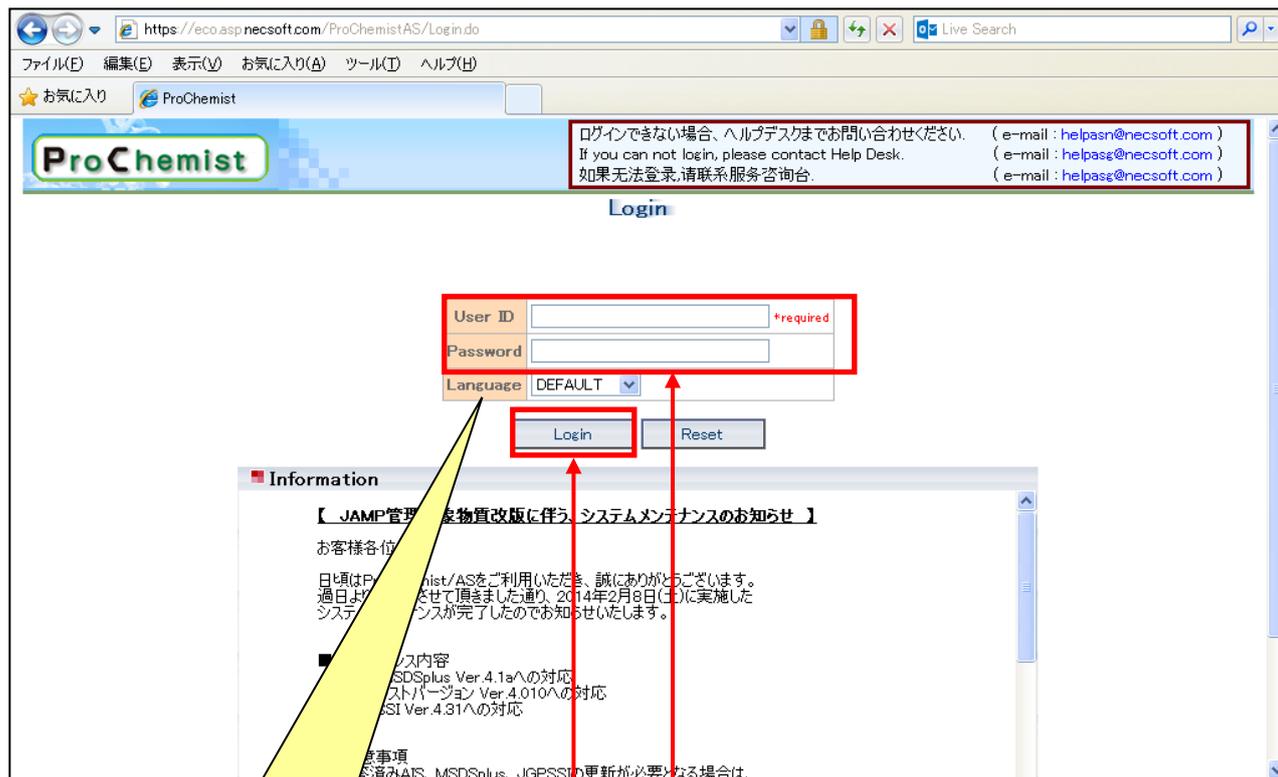

Language

ProChemist 画面の言語を変更することができます。



DEFAULT :ユーザー登録時に指定した言語

CHINESE :中国語

ENGLISH :英語

JAPANESE :日本語

1. Internet Explorer を使用して、ProChemist/AS にアクセスします。
<https://prochemist.nec.co.jp/ProChemistAS/Login.do/>
 * ProChemist/AS の「ログイン」画面が開きます。

2. 「User ID」、「Password」を入力します。
 *NECヘルプデスクから届いたユーザーID、パスワードを入力

3. 「Login」ボタンをクリックします。
 *ProChemist/AS の「Menu」画面が開きます。

操作手順4へ

ProChemist/AS メール発信設定

ProChemist

Menu Help Contact US Logout

言語変更: DEFAULT

日付: 2014/06/05
ユーザー: [ユーザー名]

業務メニュー

- 部品・部材管理
- 部品情報
 - 部品情報照会
- 部品調査依頼
 - 調査依頼登録
 - 調査依頼一括登録
 - 調査依頼一括登録結果
 - 調査指示・依頼先指定
 - 調査票個別出力
- AIS/MSDSplus登録
 - 登録
 - 一括登録
 - 一括登録結果
- 製品管理
 - 調査依頼管理
 - 回答メール照会
 - 製品調査回答
 - 受付照会
 - 製品集計
 - 構成情報登録
 - 構成情報登録結果
 - 構成情報登録・変更
 - 製品集計
 - 製品登録
 - 製品登録結果
 - 製品情報
 - 製品情報照会
 - 製品情報照会(部品指定)
 - 製品取込
 - 製品一括取込
 - 製品一括取込結果
- 含有情報管理
 - フォーマット管理
 - フォーマット変換
- マスタメンテ
 - 業務関連
 - 部品コード変換マスタ
 - 製品コード変換マスタ
 - お知らせ案内マスタ
 - 組織関連
 - 製品シリーズ群マスタ
 - 製品シリーズマスタ
 - 会社マスタ
 - 組織マスタ
 - ユーザーマスタ**
 - 取引先関連
 - 取引先マスタ
 - 取引先部門マスタ
 - 取引先担当マスタ
 - 取引先グループマスタ
 - システム関連
 - メニュー表示設定
 - パスワード変更
- 利用企業情報
 - 企業一覧(Pass:proc2010)

案内画面

■ 業務案内

■ 部品調査依頼業務

調査待ち	0	調査中	0	回答遅れ	0	回答済み	0
JAMP	0	JAMP	0	JAMP	0	JAMP	0
サプライヤWEB	0	サプライヤWEB	0	サプライヤWEB	0	サプライヤWEB	0
調査票出力要	0	個別調査	0	個別調査	0	個別調査	0
メール調査	0	メール調査	0	メール調査	0	メール調査	0
調査指示要	0	社内調査	0	社内調査	0	社内調査	0
受付エラー	0						
調査取消	0						

■ 製品集計業務

製品集計	0	集計済	0
集計確認	0	仮登録中	0

■ 製品公開・回答業務

承認依頼	0	承認済	0	公開完了	0
承認依頼中	0	JAMP	0	JAMP	0
承認遅れ	0	社外	0		
		社内	0		
		非公開	0		

■ 製品調査回答業務

型番未回答	4	型番回答済	3	製品未回答	0	製品回答済	0
未回答	2	回答済	0	未回答	0	回答済	0
回答遅延	2	取消済	3	回答遅延	0	取消済	0

■ お知らせ案内

お知らせはありません。

Mem1267.33:2275.83/3543.17
Swp:1434.5: 5487.5/ 6922.0

ProChemist

4. 左側のメニュー欄から、
“業務メニュー / マスタメンテ / 組織関連”
の中にある「ユーザーマスタ」をクリックします。
*「ユーザーマスタ検索条件」画面が開きます。

操作手順5へ

ProChemist/AS メール発信設定

ユーザーマスタ検索条件画面

ProChemist Menu Help Contact US Logout 言語変更: DEFAULT

ユーザーマスタ検索条件

検索条件を指定してください。

会社コード	<input type="text"/> <input type="button" value="選択"/>
ユーザーコード	<input type="text"/>
ユーザー名(英語)	<input type="text"/>
ユーザー名(ローカル)	<input type="text"/>
削除フラグ	null <input type="button" value="▼"/>
備考1	<input type="text"/>
備考2	<input type="text"/>
備考3	<input type="text"/>
備考4	<input type="text"/>
備考5	<input type="text"/>

表示順 会社コード 表示数 10件 昇順 降順

ProChemist

5. 「**検索**」ボタンをクリックします。
*「ユーザーマスタ照会」画面が開きます。

操作手順6へ

ProChemist/AS メール発信設定

ユーザーマスタ照会画面

ユーザーが一人の場合

ProChemist Menu Help Contact US Logout 言語変更: DEFAULT

ユーザーマスタ照会

1件見つかりました。1 ~ 1件目を表示しています。

表示件数 10件 表示順 会社コード 昇順 降順 再表示

選択	削除フラグ	会社コード	会社名(英語)	会社名(ローカル)	ユーザーCD	ユーザー名(英語)	コ
<input checked="" type="checkbox"/>							

訂正 全件リスト出力 **メール発信設定** 検索条件へ戻る

ProChemist

ユーザーが複数の場合

ProChemist Menu Help Contact US Logout 言語変更: DEFAULT

ユーザーマスタ照会

4件見つかりました。1 ~ 4件目を表示しています。

表示件数 10件 表示順 会社コード 昇順 降順 再表示

選択	削除フラグ	会社コード	会社名(英語)	会社名(ローカル)	ユーザーCD	ユーザー名(英語)	コ
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							

訂正 全件リスト出力 **メール発信設定** 検索条件へ戻る

ProChemist

6. 設定を変更するユーザーを選択します。

6a. ユーザーが一人の場合
既にチェックが入っています。

6b. ユーザーが複数の場合
設定を変更するユーザーの
「**選択**」欄にチェックを入れます。

7. 「**メール発信設定**」ボタンをクリックします。
*「メール発信設定」画面が開きます。

操作手順8へ

ProChemist/AS メール発信設定

メール発信設定画面

ProChemist Menu Help Contact US Logout 言語変更: DEFAULT

メール発信設定

会社コード: TE1301 Casio Supplier 08 カシオサプライ08
 ユーザーコード: 001 USER_8 ユーザー_8

※メール発信回数を指定しない場合、対応完了まで送信され続けます。

メール種別	メール発信間隔	メール通知回数
調査票出力待ちデータ確認のご依頼	1 日間隔	1 回通知
回答遅延データ確認のご依頼	1 日間隔	1 回通知
製品承認依頼のご連絡	1 日間隔	1 回通知
製品承認遅延のご連絡	1 日間隔	1 回通知
製品調査対応のご依頼	1 日間隔	1 回通知
製品調査回答遅延のご連絡	7 日間隔	1 回通知
製品調査回答遅延(型番未回答)のご連絡	7 日間隔	1 回通知

登録 リセット 戻る

ProChemist/AS メール発信設定 概要

1. 製品調査対応のご依頼

・ProChemist/AS から発信される「調査依頼メール」の発信間隔と回数を指定します。

*この設定をしなかった場合

含有化学物質データを回答する日まで、毎日、同じ部品の「調査依頼メール」が、ProChemist/AS から発信されます。

・メール発信間隔: 1 日間隔 メール通知回数: 1 回通知

(上記の設定により、調査依頼日当日に、1 回だけ、調査依頼メールが発信されます。)

2. 製品調査回答遅延のご連絡

3. 製品回答遅延(型番未回答)のご連絡

・回答期限までに、含有化学物質データをご回答いただけなかった場合は、ProChemist/AS から「製品調査回答遅延のご連絡メール」が発信されます。

・ProChemist/AS から発信される「回答遅延のご連絡メール」の発信間隔と回数を指定します。

*この設定をしなかった場合

回答期限日以降、含有化学物質データを回答する日まで、毎日、同じ部品の「回答遅延メール」が、ProChemist/AS から発信されます。

・メール発信間隔: 7 日間隔 メール通知回数: (空欄) 回通知

(上記の設定により、回答期限日以降、1 週間間隔で回答遅延メールが発信されます。)

・「調査票出力待ちデータ確認のご依頼」「回答遅延データ確認のご依頼」

「製品承認依頼のご連絡」「製品承認遅延のご連絡」などの他項目は、使用しませんので、設定は不要です。

メール発信設定完了画面

ProChemist Menu Help Contact US Logout 言語変更: DEFAULT

メール発信設定完了

メール発信設定の登録が完了しました。
 メール発信設定へ戻る

以上で、「メール発信設定」の登録は終了です。